



УКРАЇНА



(11) 30941

(19) (UA)

(51) 7 G01F23/28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ПАТЕНТ на винахід

видано відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності

М. Паладій



(21) 98063259
(22) 23.06.1998
(24) 15.01.2002
(46) 15.01.2002. Бюл. № 1

(72) Гордєєв Борис Миколаєвич, Жуков Юрій Даніїлович, Колпак Богдан Дмитрович,
Наталюк Михайло Филимонович, Леонтьєв Анатолій Володимирович
(73) Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "AMICO"

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ, МЕЖ ПОДІЛУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ РІДКИХ І
СИПКИХ СЕРЕДОВИЩ

(21) № 98063259
(54) (57)

Спосіб визначення рівня, меж поділу та температури рідких і сипких середовищ, який містить в собі такі дії: виробляють генератором зондувальних імпульсів сигнал, який являє собою накладення відеосигналу та сигналу перепаду напруги, за допомогою чутливого елемента випромінюють його у контролюване середовище, приймають відбитий сигнал, за допомогою стробоскопічного перетворювача, аналого-цифрового перетворювача та обчислювального пристрою послідовно виконують обробку прийнятого сигналу та за його формою визначають межі поділу і температуру середовищ, який відрізняється тим, що здійснюють періодичну перевірку результатів вимірювань під час роботи вимірювальної системи на штатному робочому місці за допомогою зразкової міри шляхом порівняння відбитків від меж поділу та зразкової міри і обчисленням величин відхилення за алгоритмом, що враховує зміщення координат зразкової міри.

- (56) 1. RU, 2073214, 10.02.1997, МПК G 01F 23/00;
2. UA, 11006, 31.03.1993, МПК G 01F 23/00;
3. SU, 1368809, МПК G 01F 23/28;
4. US, 3695107, 03.10.1972, МПК G 01F 23/284;
5. WO, 98/17981, 17.09.1997, МПК G 01F 23/00.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

УКРАЇНА

(19) UA (11) 30941 (13) C2

(51) 6 G01F23/28

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ, МЕЖ ПОДІЛУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ РІДКИХ І СИПКИХ СЕРЕДОВИЩ

1

2

- (21) 98063259
 (22) 23.06.1998
 (24) 15.01.2002
 (46) 15.01.2002, Бюл. № 1, 2002 р.
 (72) Гордєєв Борис Миколаєвич, Жуков Юрій Даніїлович, Колпак Богдан Дмитрович, Наталюк Михайло Филимонович, Леонтьєв Анатолій Володимирович
 (73) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "AMICO"
 (56) 1. RU, 2073214, 10.02.1997, МПК G 01F 23/00
 2. UA, 11006, 31.03.1993, МПК G 01F 23/00
 3. SU, 1368809, МПК G 01F 23/28
 4. US, 3695107, 03.10.1972, МПК G 01F 23/284
 5. WO, 98/17981, 17.09.1997, МПК G 01F 23/00.
 (57) Спосіб визначення рівня, меж поділу та температури рідких і сипких середовищ, який містить в собі такі дії: виробляють генератором зонду-

вальних імпульсів сигнал, який являє собою накладення відеосигналу та сигналу перепаду напруги, за допомогою чутливого елемента випромінюють його у контролюване середовище, приймають відбитий сигнал, за допомогою стробоскопічного перетворювача, аналого-цифрового перетворювача та обчислювального пристрою послідовно виконують обробку прийнятого сигналу та за його форму визначають межі поділу і температуру середовищ, який відрізняється тим, що здійснюють періодичну перевірку результатів вимірювань під час роботи вимірювальної системи на штатному-робочому місці за допомогою зразкової міри шляхом порівняння відбитків від меж поділу та зразкою міри і обчисленням величин відхилення за алгоритмом, що враховує зміщення координат зразкової міри.

Винахід стосується вимірювальної техніки і може бути використаний для вимірювання рівнів та меж поділу рідких і сипких середовищ з регулярною автоматичною перевіркою результатів в процесі роботи.

Відомо про спосіб вимірювання параметрів зберігання: рівня та температури рідин різної густини в резервуарі (патент Франції №2624968, MKH5G01F23/00, 1990 р.). Тут в лінію затримки, яку занурено в рідину, надсилають імпульси напруги. При різних густинах рідини буде різна швидкість проходження імпульсів в лінії затримки, відстань між відбитими імпульсами відповідає різним шарам рідини. Цей спосіб відрізняється зниженою точністю, складністю конструкції чутливого елемента – лінії затримки, що містить потребу забезпечення в ній вакууму, і неможливість роботи з сипким вантажем, потребує переривання технологічного процесу для проведення планових перевірок системи. Загальними зі способом, що заявляється, є такі ознаки: в середовище, що контролюється, за допомогою чутливого елемента випромінюють сигнал, приймають відбитий сигнал і за часом затримки визначають рівень.

Відомо про спосіб вимірювання та автоматич-

ного контролю ланцюгів вимірювальних датчиків, який містить підключення вимірювальних датчиків до групового вимірювального перетворювача після підсилення сигналу і неперервний контроль цілісності датчиків, з'єднувальної лінії та спрацьування комутаторів (а.с. CPCP № 13811435 "Многоканальная система измерений с контролем"). При цьому контроль елементів системи здійснюють за допомогою силового транзистора, який має один вхід і два виходи. Загальними зі способом, що заявляється, ознаками є: вимірювання після підсилення сигналів від вимірювальних датчиків на вимірювальному перетворювачі, контроль роботи елементів та вимірювальної системи. Спосіб по а.с. CPCP № 13811435 поряд з вимірюванням дозволяє контролювати та виявляти несправності елементів системи, але не враховує похиби вимірювань, що виникають при зміні характеристик елементів з часом, при зміні зовнішніх умов.

Також відомо про спосіб перевірки багатозначної міри опору, який містить підключення до джерела живлення, сходинкове порівняння з калібруваними зразками міри, що виконані у вигляді додаткового магазину опору, регулювання напруги та зчитування показань для подальшого визна-

UA (19) 30941 (11) 30941 (13) C2

чення похибок вимірювань (а.с. СРСР №1368809 "Устройство для проверки многозначной меры сопротивлений"). У порівнянні зі способом по а.с. СРСР №1381435 цей спосіб дозволяє підвищити точність вимірювань, похибка не перевищує 0,002%. Цього досягають тривалими багатосходинковими вимірюваннями, що виконуються вручну та в умовах лабораторії. Такий спосіб неможливо використати поза лабораторних умов і його неможливо застосувати для вимірювання елементів з різноманітними характеристиками. Загальними зі способом, що заявляється, є ознаки: підключення до джерела живлення, порівняння з каліброваною мірою, зчитування та визначення похибок вимірювань.

Найбільш близьким до пропонованого винаходу по технічній сутності та результату, що досягається, є "Способ визначення рівня, меж поділу і температури рідких та сипких середовищ" за патентом України № 11006 МПК5О01Р23/285 1993 р. Спосіб містить в собі такі дії: виробляють генератором зондувальних імпульсів сигнал, який являє собою накладення відеосигналу і сигналу перепаду напруги, за допомогою чутливого елемента випромінюють його в контролюване середовище, приймають відбитий сигнал, а за допомогою послідовно з'єднаних стробоскопічного перетворювача, аналого-цифрового перетворювача та обчислювального пристрою виконують обробку прийнятого сигналу і за його форму визначають межі поділу та температури середовищ. В порівнянні з попереднім способом (за а.с. СРСР №1368809) даний спосіб дозволяє розширити діапазон параметрів, що вимірюються, візуалізувати процес вимірювань в реальному часі та прискорити обчислення. Однак цей спосіб не дозволяє виконувати перевірку результатів вимірювань під час роботи системи. Для перевірки системи необхідно проводити роботи в лабораторних умовах. Такі перевірки переривають технологічний процес і не забезпечують ідентичної роботи системи на штатному робочому місці. Загальними зі способом, що заявляється, є такі ознаки: виробляють генератором зондувальних імпульсів сигнал, який являє собою накладення відеосигналу та сигналу перепаду напруги, за допомогою чутливого елемента випромінюють його в контролюване середовище, приймають відбитий сигнал, а за допомогою стробоскопічного перетворювача, аналого-цифрового перетворювача та обчислювального пристрою послідовно виконують обробку прийнятого сигналу і за його форму визначають межі поділу і температуру середовищ.

В основу винаходу поставлено задачу удосконалення способу визначення рівня, меж поділу та температур рідких і сипких середовищ, в якому при періодичному контролі на штатному робочому місці і корегуванні вимірюваних параметрів забезпечують підвищення точності вимірювань, надійності роботи системи і за рахунок цього усуваються витрати і час на планові перевірки системи, забезпечується неперервність технологічного процесу.

Задачу, яку поставлено, вирішують тим, що в способі визначення рівня, меж поділу та температур рідких і сипких середовищ, який містить такі дії: виробляють генератором зондувальних імпульсів

зондувальних імпульсів сигнал, який являє собою накладення видеосигналу та сигналу перепаду напруги, за допомогою чутливого елемента випромінюють його в контролюване середовище, приймають відбитий сигнал, а за допомогою стробоскопічного перетворювача, аналого-цифрового перетворювача та обчислювального пристрою послідовно виконують обробку прийнятого сигналу і за його форму визначають межі поділу і температури середовищ, згідно з винаходом здійснюють періодичну перевірку результатів вимірювань під час роботи вимірювальної системи на штатному робочому місці за допомогою зразкової міри і обчисленням величин відхилення за алгоритмом, який враховує зміщення координат зразкової міри.

Як зразкову міру використовують калібраний відрізок кабелю зі сталими параметрами. Використання за зразкову міру каліброваного відрізку кабелю зі сталими параметрами дозволяє просто, з найменшими витратами виконувати перевірку системи на штатному робочому місці. Для контролю параметрів, що вимірюються, тобто нагляд за їх зміщенням, використовують зміщення координат зразкової міри. За допомогою спеціального алгоритму в режимі перевірки зміщують сигнал на таку величину, щоб відбиток від кінця зразкової міри відповідав зразковому значенню рівня, який раніше занотовано в пам'ять обчислювача за допомогою зразкової міри. Після оцінки розкиду значень можна прияти рішення про вірогідність вимірювань, що виконуються. Оскільки контроль і оцінювання параметрів, що вимірюються, виконують під час роботи вимірювальної системи, то підвищується надійність системи, тому що розлад можна виявити в момент його появи. Перевірка параметрів, що вимірюються, на штатному робочому місці, їх корегування в момент впливу різноманітних зовнішніх факторів дозволяє значно підвищити точність вимірювань. В порівнянні з прототипом точність можна підвищити на 30 – 50%.

Наведені малюнки ілюструють здійснення способу визначення рівня, меж поділу та температури рідких і сипких середовищ. На фіг.1 показано функціональну схему системи вимірювань з автоматичною перевіркою результатів вимірювань. На фіг.2 наведені співвідношення в часі, які пояснюють роботу в двох режимах: 2а – в режимі вимірювання, 2б – в режимі перевірки.

Система вміщує генератор зондувальних імпульсів 1, приймач 2, чутливий елемент, який виконано у вигляді ізольованих один від одного провідників 3, послідовно з'єднані стробоскопічний перетворювач 4, аналого-цифровий перетворювач (АЦП) 5 та обчислювальний пристрій 6. Комутатор 7 служить для присуднання вимірювального пристрою 6 до чутливих елементів різних каналів багатоканальної системи вимірювань. Кожен вимірювальний канал споряджено зразковою мірою 8, яку встановлено поміж чутливим елементом та генератором зондувальних імпульсів 1. Систему споряджено спеціальним математичним забезпеченням 9, яке вміщує алгоритм з урахуванням зміщення координат зразкової міри. Зразкова міра визначеною довжиною може бути виготовлена з кабелю з високосталими параметрами, наприклад, із

радіокабелю з фторопластовою ізоляцією типу РК 75-422. Цей відрізок кабелю влаштовують в кожний канал перед чутливим елементом, який служить зразковою мірою для цього каналу.


Здійснюють спосіб таким чином. Генератором зондувальних імпульсів 1 виробляють сигнал, який являє собою накладення відеосигналу та сигналу перепаду напруги, спрямовують його за допомогою чутливого елемента, який виконано у вигляді ізольованих один від одного провідників 1 в контролюване середовище по будь-якому з каналів, який приєднано комутатором 7. Контрольованім середовищем може бути рідина з різними густинами або сипкий матеріал. Приймають відбитий сигнал за допомогою приймача 2 і за часом затримки визначають рівень, а за допомогою послідовно з'єднаних стробоскопічного перетворювача 4, АЦП 5 та обчислювального пристрою 6 визначають межі поділу та температури середовищ. На фіг.2а зображені сигнали в системі під час роботи в режимі вимірювання рівня. Тут T_1 – затримка сигналу, відбитого від рівня відносно зондувального; T_2 – затримка сигналу, відбитого від межі поділу середовищ відносно зондувального; T_3 – затримка сигналу, відбитого від початку зразкової міри. Ця затримка може регулюватися програмним способом за допомогою математичного забезпечення 9 і встановлюється обчислювальним пристроям 6. Її встановлення не впливає на результат вимірювання рівня. T_0 – затримка, що визначається довжиною зразкової міри 8. Вона завжди постійна. Фіг.2б зображує сигнали в системі під час роботи в режимі перевірки. В режимі перевірки сигнал, що визначає рівень середовища, запам'ятовується в обчислювальному пристрой 6. Далі, за допомогою спеціального алгоритму математичного забезпечення 9, зміщують місцеположення зразкової міри 8 на таку величину T_n щоб відбиток від кінця зразкової міри 8 співвідносився із зразковим значенням рівня, раніше занотованим в пам'ять обчислювача 6 за допомогою зразкової міри 8. Після оцінки розкиду значень Δ можна приймати рішення про вірогідність вимірювань, що виконуються.

Генератор 1, приймач 2, чутливий елемент 3, стробоскопічний перетворювач 4, АЦП 5, обчислювальний пристрій 6 можуть бути використані також, які наведено в патенті України № 11006.


Таким чином, використовуючи зразкову міру, яку встановлено попереду чутливого елемента на штатному робочому місці, знаючи затримки сигналів від кінців зразкової міри, рівня середовища, можна виконувати періодичну перевірку результатів вимірювань, не перериваючи технологічного процесу, і підвищити точність вимірювань.

Періодичність переходу системи в режим перевірки вимірювань визначається алгоритмом роботи всієї системи і виконується автоматично.

Щоб підвищити точність вимірювань, тарірування провідників 3 чутливого елемента проводять на штатному робочому місці. Це дозволяє уникнути похибки від зміни місця тарірування.

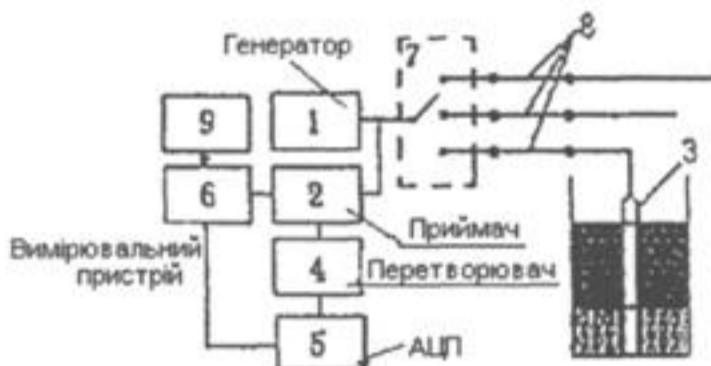

Фіг.1

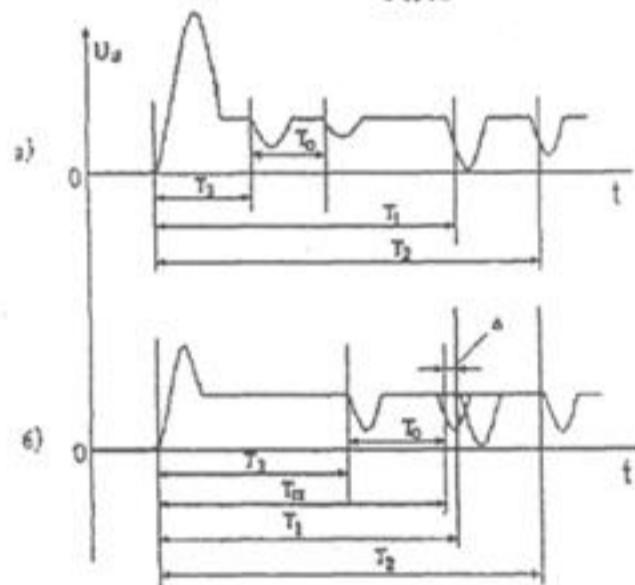

Фіг.2